wellion SENSOR

mg/dL

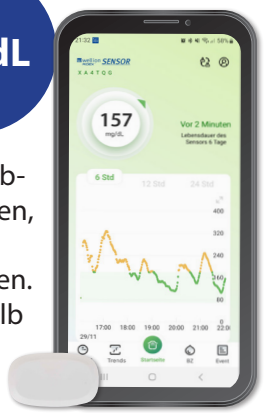

## ABWEICHUNGSTABELLE +/-20%

Die Kalibrierung Ihres Sensors ist optional. Sie können den Wert des Blutzuckermessgeräts zur Kalibrierung eingeben, wenn der Unterschied zum Sensorwert mehr als 20 % beträgt. Es wird empfohlen, zur Kalibrierung Ihres Sensors Blutzuckermesswerte zu verwenden, die über 72 mg/dL liegen.

- Mithilfe der Kalibrierung können Sie Ihre Sensor-Messwerte mit Ihren Blutzuckerwerten abgleichen.
- Wenn Sie Ihren Sensor kalibrieren möchten, geben Sie den gemessenen Blutzuckerwert innerhalb von fünf Minuten nach der Blutentnahme durch einen Fingerstich ein.
- Eine Kalibrierung wird nicht empfohlen, wenn die Blutzuckerwerte schnell steigen oder fallen.

| -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 43 | 61 | 76 | 91 | 93 | 116 | 139 |
| 30 | 37 | 44 | 62 | 77 | 92 | 94 | 117 | 140 |
| 30 | 38 | 46 | 62 | 78 | 94 | 94 | 118 | 142 |
| 31 | 39 | 47 | 63 | 79 | 95 | 95 | 119 | 143 |
| 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 96 | 120 | 144 |
| 33 | 41 | 49 | 65 | 81 | 97 | 97 | 121 | 145 |
| 34 | 42 | 50 | 66 | 82 | 98 | 98 | 122 | 146 |
| 34 | 43 | 52 | 66 | 83 | 100 | 98 | 123 | 148 |
| 35 | 44 | 53 | 67 | 84 | 101 | 99 | 124 | 149 |
| 36 | 45 | 54 | 68 | 85 | 102 | 100 | 125 | 150 |
| 37 | 46 | 55 | 69 | 86 | 103 | 101 | 126 | 151 |
| 38 | 47 | 56 | 70 | 87 | 104 | 102 | 127 | 152 |
| 38 | 48 | 58 | 70 | 88 | 106 | 102 | 128 | 154 |
| 39 | 49 | 59 | 71 | 89 | 107 | 103 | 129 | 155 |
| 40 | 50 | 60 | 72 | 90 | 108 | 104 | 130 | 156 |
| 41 | 51 | 61 | 73 | 91 | 109 | 105 | 131 | 157 |
| 42 | 52 | 62 | 74 | 92 | 110 | 106 | 132 | 158 |
| 42 | 53 | 64 | 74 | 93 | 112 | 106 | 133 | 160 |
| 43 | 54 | 65 | 75 | 94 | 113 | 107 | 134 | 161 |
| 44 | 55 | 66 | 76 | 95 | 114 | 108 | 135 | 162 |
| 45 | 56 | 67 | 77 | 96 | 115 | 109 | 136 | 163 |
| 46 | 57 | 68 | 78 | 97 | 116 | 110 | 137 | 164 |
| 46 | 58 | 70 | 78 | 98 | 118 | 110 | 138 | 166 |
| 47 | 59 | 71 | 79 | 99 | 119 | 111 | 139 | 167 |
| 48 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 112 | 140 | 168 |
| 49 | 61 | 73 | 81 | 101 | 121 | 113 | 141 | 169 |
| 50 | 62 | 74 | 82 | 102 | 122 | 114 | 142 | 170 |
| 50 | 63 | 76 | 82 | 103 | 124 | 114 | 143 | 172 |
| 51 | 64 | 77 | 83 | 104 | 125 | 115 | 144 | 173 |
| 52 | 65 | 78 | 84 | 105 | 126 | 116 | 145 | 174 |
| 53 | 66 | 79 | 85 | 106 | 127 | 117 | 146 | 175 |
| 54 | 67 | 80 | 86 | 107 | 128 | 118 | 147 | 176 |
| 54 | 68 | 82 | 86 | 108 | 130 | 118 | 148 | 178 |
| 55 | 69 | 83 | 87 | 109 | 131 | 119 | 149 | 179 |
| 56 | 70 | 84 | 88 | 110 | 132 | 120 | 150 | 180 |
| 57 | 71 | 85 | 89 | 111 | 133 | 121 | 151 | 181 |
| 58 | 72 | 86 | 90 | 112 | 134 | 122 | 152 | 182 |
| 58 | 73 | 88 | 90 | 113 | 136 | 122 | 153 | 184 |
| 59 | 74 | 89 | 91 | 114 | 137 | 123 | 154 | 185 |
| 60 | 75 | 90 | 92 | 115 | 138 | 124 | 155 | 186 |

SEN015 20250613

wellion SENSOR

mg/dL

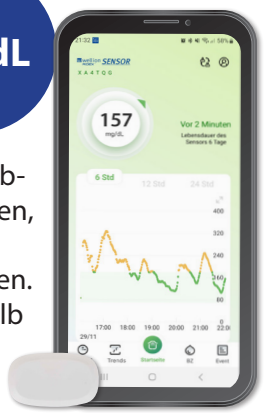

## ABWEICHUNGSTABELLE +/-20%

Die Kalibrierung Ihres Sensors ist optional. Sie können den Wert des Blutzuckermessgeräts zur Kalibrierung eingeben, wenn der Unterschied zum Sensorwert mehr als 20 % beträgt. Es wird empfohlen, zur Kalibrierung Ihres Sensors Blutzuckermesswerte zu verwenden, die über 72 mg/dL liegen.

- Mithilfe der Kalibrierung können Sie Ihre Sensor-Messwerte mit Ihren Blutzuckerwerten abgleichen.
- Wenn Sie Ihren Sensor kalibrieren möchten, geben Sie den gemessenen Blutzuckerwert innerhalb von fünf Minuten nach der Blutentnahme durch einen Fingerstich ein.
- Eine Kalibrierung wird nicht empfohlen, wenn die Blutzuckerwerte schnell steigen oder fallen.

| -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 156 | 187 | 157 | 196 | 235 | 189 | 236 | 283 |
| 126 | 157 | 188 | 158 | 197 | 236 | 190 | 237 | 284 |
| 126 | 158 | 190 | 158 | 198 | 238 | 190 | 238 | 286 |
| 127 | 159 | 191 | 159 | 199 | 239 | 191 | 239 | 287 |
| 128 | 160 | 192 | 160 | 200 | 240 | 192 | 240 | 288 |
| 129 | 161 | 193 | 161 | 201 | 241 | 193 | 241 | 289 |
| 130 | 162 | 194 | 162 | 202 | 242 | 194 | 242 | 290 |
| 130 | 163 | 196 | 162 | 203 | 244 | 194 | 243 | 292 |
| 131 | 164 | 197 | 163 | 204 | 245 | 195 | 244 | 293 |
| 132 | 165 | 198 | 164 | 205 | 246 | 196 | 245 | 294 |
| 133 | 166 | 199 | 165 | 206 | 247 | 197 | 246 | 295 |
| 134 | 167 | 200 | 166 | 207 | 248 | 198 | 247 | 296 |
| 134 | 168 | 202 | 166 | 208 | 250 | 198 | 248 | 298 |
| 135 | 169 | 203 | 167 | 209 | 251 | 199 | 249 | 299 |
| 136 | 170 | 204 | 168 | 210 | 252 | 200 | 250 | 300 |
| 137 | 171 | 205 | 169 | 211 | 253 | 201 | 251 | 301 |
| 138 | 172 | 206 | 170 | 212 | 254 | 202 | 252 | 302 |
| 138 | 173 | 208 | 170 | 213 | 256 | 202 | 253 | 304 |
| 139 | 174 | 209 | 171 | 214 | 257 | 203 | 254 | 305 |
| 140 | 175 | 210 | 172 | 215 | 258 | 204 | 255 | 306 |
| 141 | 176 | 211 | 173 | 216 | 259 | 205 | 256 | 307 |
| 142 | 177 | 212 | 174 | 217 | 260 | 206 | 257 | 308 |
| 142 | 178 | 214 | 174 | 218 | 262 | 206 | 258 | 310 |
| 143 | 179 | 215 | 175 | 219 | 263 | 207 | 259 | 311 |
| 144 | 180 | 216 | 176 | 220 | 264 | 208 | 260 | 312 |
| 145 | 181 | 217 | 177 | 221 | 265 | 209 | 261 | 313 |
| 146 | 182 | 218 | 178 | 222 | 266 | 210 | 262 | 314 |
| 146 | 183 | 220 | 178 | 223 | 268 | 210 | 263 | 316 |
| 147 | 184 | 221 | 179 | 224 | 269 | 211 | 264 | 317 |
| 148 | 185 | 222 | 180 | 225 | 270 | 212 | 265 | 318 |
| 149 | 186 | 223 | 181 | 226 | 271 | 213 | 266 | 319 |
| 150 | 187 | 224 | 182 | 227 | 272 | 214 | 267 | 320 |
| 150 | 188 | 226 | 182 | 228 | 274 | 214 | 268 | 322 |
| 151 | 189 | 227 | 183 | 229 | 275 | 215 | 269 | 323 |
| 152 | 190 | 228 | 184 | 230 | 276 | 216 | 270 | 324 |
| 153 | 191 | 229 | 185 | 231 | 277 | 217 | 271 | 325 |
| 154 | 192 | 230 | 186 | 232 | 278 | 218 | 272 | 326 |
| 154 | 193 | 232 | 186 | 233 | 280 | 218 | 273 | 328 |
| 155 | 194 | 233 | 187 | 234 | 281 | 219 | 274 | 329 |
| 156 | 195 | 234 | 188 | 235 | 282 | 220 | 275 | 330 |

SEN015 20250613

wellion SENSOR

mg/dL

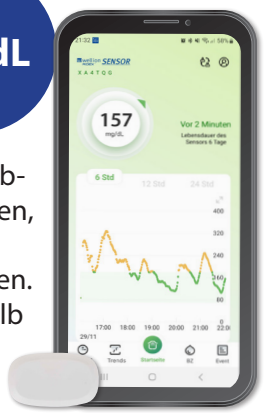

## ABWEICHUNGSTABELLE +/-20%

Die Kalibrierung Ihres Sensors ist optional. Sie können den Wert des Blutzuckermessgeräts zur Kalibrierung eingeben, wenn der Unterschied zum Sensorwert mehr als 20 % beträgt. Es wird empfohlen, zur Kalibrierung Ihres Sensors Blutzuckermesswerte zu verwenden, die über 72 mg/dL liegen.

- Mithilfe der Kalibrierung können Sie Ihre Sensor-Messwerte mit Ihren Blutzuckerwerten abgleichen.
- Wenn Sie Ihren Sensor kalibrieren möchten, geben Sie den gemessenen Blutzuckerwert innerhalb von fünf Minuten nach der Blutentnahme durch einen Fingerstich ein.
- Eine Kalibrierung wird nicht empfohlen, wenn die Blutzuckerwerte schnell steigen oder fallen.

| -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% | -20% | Glucose | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 276 | 331 | 253 | 316 | 379 | 285 | 356 | 427 |
| 222 | 277 | 332 | 254 | 317 | 380 | 286 | 357 | 428 |
| 222 | 278 | 334 | 254 | 318 | 382 | 286 | 358 | 430 |
| 223 | 279 | 335 | 255 | 319 | 383 | 287 | 359 | 431 |
| 224 | 280 | 336 | 256 | 320 | 384 | 288 | 360 | 432 |
| 225 | 281 | 337 | 257 | 321 | 385 | 289 | 361 | 433 |
| 226 | 282 | 338 | 258 | 322 | 386 | 290 | 362 | 434 |
| 226 | 283 | 340 | 258 | 323 | 388 | 290 | 363 | 436 |
| 227 | 284 | 341 | 259 | 324 | 389 | 291 | 364 | 437 |
| 228 | 285 | 342 | 260 | 325 | 390 | 292 | 365 | 438 |
| 229 | 286 | 343 | 261 | 326 | 391 | 293 | 366 | 439 |
| 230 | 287 | 344 | 262 | 327 | 392 | 294 | 367 | 440 |
| 230 | 288 | 346 | 262 | 328 | 394 | 294 | 368 | 442 |
| 231 | 289 | 347 | 263 | 329 | 395 | 295 | 369 | 443 |
| 232 | 290 | 348 | 264 | 330 | 396 | 296 | 370 | 444 |
| 233 | 291 | 349 | 265 | 331 | 397 | 297 | 371 | 445 |
| 234 | 292 | 350 | 266 | 332 | 398 | 298 | 372 | 446 |
| 234 | 293 | 352 | 266 | 333 | 400 | 298 | 373 | 448 |
| 235 | 294 | 353 | 267 | 334 | 401 | 299 | 374 | 449 |
| 236 | 295 | 354 | 268 | 335 | 402 | 300 | 375 | 450 |
| 237 | 296 | 355 | 269 | 336 | 403 | 301 | 376 | 451 |
| 238 | 297 | 356 | 270 | 337 | 404 | 302 | 377 | 452 |
| 238 | 298 | 358 | 270 | 338 | 406 | 302 | 378 | 454 |
| 239 | 299 | 359 | 271 | 339 | 407 | 303 | 379 | 455 |
| 240 | 300 | 360 | 272 | 340 | 408 | 304 | 380 | 456 |
| 241 | 301 | 361 | 273 | 341 | 409 | 305 | 381 | 457 |
| 242 | 302 | 362 | 274 | 342 | 410 | 306 | 382 | 458 |
| 242 | 303 | 364 | 274 | 343 | 412 | 306 | 383 | 460 |
| 243 | 304 | 365 | 275 | 344 | 413 | 307 | 384 | 461 |
| 244 | 305 | 366 | 276 | 345 | 414 | 308 | 385 | 462 |
| 245 | 306 | 367 | 277 | 346 | 415 | 309 | 386 | 463 |
| 246 | 307 | 368 | 278 | 347 | 416 | 310 | 387 | 464 |
| 246 | 308 | 370 | 278 | 348 | 418 | 310 | 388 | 466 |
| 247 | 309 | 371 | 279 | 349 | 419 | 311 | 389 | 467 |
| 248 | 310 | 372 | 280 | 350 | 420 | 312 | 390 | 468 |
| 249 | 311 | 373 | 281 | 351 | 421 | 313 | 391 | 469 |
| 250 | 312 | 374 | 282 | 352 | 422 | 314 | 392 | 470 |
| 250 | 313 | 376 | 282 | 353 | 424 | 314 | 393 | 472 |
| 251 | 314 | 377 | 283 | 354 | 425 | 315 | 394 | 473 |
| 252 | 315 | 378 | 284 | 355 | 426 | 316 | 395 | 474 |

SEN015 20250613

wellion SENSOR

mg/dL

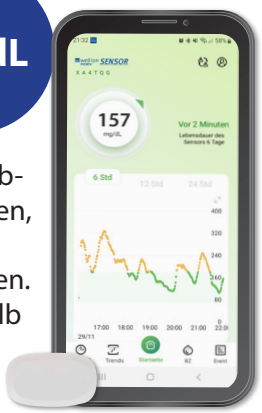


## ABWEICHUNGSTABELLE +/-20%

Die Kalibrierung Ihres Sensors ist optional. Sie können den Wert des Blutzuckermessgeräts zur Kalibrierung eingeben, wenn der Unterschied zum Sensorwert mehr als 20 % beträgt. Es wird empfohlen, zur Kalibrierung Ihres Sensors Blutzuckermesswerte zu verwenden, die über 72 mg/dL liegen.

- Mithilfe der Kalibrierung können Sie Ihre Sensor-Messwerte mit Ihren Blutzuckerwerten abgleichen.
- Wenn Sie Ihren Sensor kalibrieren möchten, geben Sie den gemessenen Blutzuckerwert innerhalb von fünf Minuten nach der Blutentnahme durch einen Fingerstich ein.
- Eine Kalibrierung wird nicht empfohlen, wenn die Blutzuckerwerte schnell steigen oder fallen.

| -20% | Glucose | +20% |
|---|---|---|
| 317 | 396 | 475 |
| 318 | 397 | 476 |
| 318 | 398 | 478 |
| 319 | 399 | 479 |
| 320 | 400 | 480 |
| 321 | 401 | 481 |
| 322 | 402 | 482 |
| 322 | 403 | 484 |
| 323 | 404 | 485 |
| 324 | 405 | 486 |
| 325 | 406 | 487 |
| 326 | 407 | 488 |
| 326 | 408 | 490 |
| 327 | 409 | 491 |
| 328 | 410 | 492 |
| 329 | 411 | 493 |
| 330 | 412 | 494 |
| 330 | 413 | 496 |
| 331 | 414 | 497 |
| 332 | 415 | 498 |
| 333 | 416 | 499 |
| 334 | 417 | 500 |
| 334 | 418 | 502 |
| 335 | 419 | 503 |
| 336 | 420 | 504 |
| 337 | 421 | 505 |
| 338 | 422 | 506 |
| 338 | 423 | 508 |
| 339 | 424 | 509 |
| 340 | 425 | 510 |
| 341 | 426 | 511 |
| 342 | 427 | 512 |
| 342 | 428 | 514 |
| 343 | 429 | 515 |
| 344 | 430 | 516 |
| 345 | 431 | 517 |
| 346 | 432 | 518 |
| 346 | 433 | 520 |
| 347 | 434 | 521 |
| 348 | 435 | 522 |

| -20% | Glucose | +20% |
|---|---|---|
| 349 | 436 | 523 |
| 350 | 437 | 524 |
| 350 | 438 | 526 |
| 351 | 439 | 527 |
| 352 | 440 | 528 |
| 353 | 441 | 529 |
| 354 | 442 | 530 |
| 354 | 443 | 532 |
| 355 | 444 | 533 |
| 356 | 445 | 534 |
| 357 | 446 | 535 |
| 358 | 447 | 536 |
| 358 | 448 | 538 |
| 359 | 449 | 539 |
| 360 | 450 | 540 |

SEN015 20250613